



Instituto Nacional de Cancerología E.S.E
Grupo Archivo General y Correspondencia

No. Radicación: SAL-03166-2014

Fecha de Rad.: 2014-05-06 09:16:34 AM

686976



Instituto Nacional
de Cancerología-ESE
Colombia
Por el control del cáncer

686976

Señora

CIELO PARADA

Sales Engineer

DRAEGER COLOMBIA S.A

Maria.parada@draeuer.com

Bogotá

RESPUESTA: CONVOCATORIA PÚBLICA 024 DE 2014.

En respuesta al correo electrónico enviado el día 02 de Mayo de 2014 a las 04:32 p.m, le manifiesto que:

PRIMERA PREGUNTA

"...

ITEM 2 MONITOR DE SIGNOS VITALES COMPATIBLE CON RESONADOR:

1.1 Monitor configurado o modular con pantalla de 12" como mínimo: Solicitamos a ustedes permitir pantallas de 10" ya que por ser un equipo tan especializado y por tener materiales compatibles con el resonador, no permiten equipo de tamaños tan grande.

"..."

RESPUESTA

El Instituto Nacional de Cancerología – ESE, le informa que se surtió la adenda No. 3, Ítem No. 2, la cual podrá ser consultada en nuestra página web www.cancer.gov.co link contrataciones.

SEGUNDA PREGUNTA

"...

1.4 Pantalla a color tecnología LCD: Solicitamos se permita ofrecer mejores tecnologías como la TFT.

"..."

RESPUESTA

El Instituto Nacional de Cancerología – ESE, le informa que se surtió la adenda No. 3, Ítem No.2, la cual podrá ser consultada en nuestra página web www.cancer.gov.co link contrataciones.

TERCERA PREGUNTA

"...

1.11. Memoria de las últimas 24 horas para PNI, SPO2, FRECUENCIA DE PULTOS Y CURVA PLETISMOGRAFO: solicitamos se permita solo datos, no necesidad de curvas.

"..."

RESPUESTA



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

PROSPERIDAD
PARA TODOS

El Instituto Nacional de Cancerología – ESE, le manifiesta que la curva de pletismografía se considera un dato importante para el análisis del estado del paciente, la grabación de este parámetro ofrece ventajas clínicas, varias marcas permiten su almacenamiento por lo que no se considera viable la modificación solicitada.

CUARTA PREGUNTA

“...

ITEM 3 MAQUINA DE ANESTESIA COMPATIBLE CON ANESTESIA:

1.1 Equipo diseñado para ser usado en entornos magnéticos, certificado para soportar hasta 300 Gauss: Solicitamos se permita mejorar la especificación permitiendo hasta 400 Gauss.

...”

RESPUESTA

El Instituto Nacional de Cancerología – ESE, le informa que se surtió la adenda No. 3, ítem No. 3, la cual podrá ser consultada en nuestra página web www.cancer.gov.co link contrataciones.

QUINTA PREGUNTA

“...

1.4 Equipo con soporte de batería de mínimo una hora: Solicitamos se permita equipos que puedan operar con batería de 45 minutos, lo cual es suficiente para que entre a operar la planta de emergencia de la Insitución.

...”

RESPUESTA

El Instituto Nacional de Cancerología – ESE, le informa que se surtió la adenda No. 3, ítem No. 3, la cual podrá ser consultada en nuestra página web www.cancer.gov.co link contrataciones.

SEXTA PREGUNTA

“...

2.2. Volumen control de 20 a 1500: Solicitamos se permita equipos hasta 1400 ml.

...”

RESPUESTA

El Instituto Nacional de Cancerología – ESE, le informa que se surtió la adenda No. 3, ítem No. 3, la cual podrá ser consultada en nuestra página web www.cancer.gov.co link contrataciones

SEXTA PREGUNTA

“...

En el numeral 5 solicitan monitor de gases anestésicos, lo cual solicitamos sea retirado del ítem de la máquina ya que este equipo se encuentra solicitado en forma independiente.

RESPUESTA

El Instituto Nacional de Cancerología – ESE, le informa que se surtió la adenda No. 3, ítem No. 3, la cual podrá ser consultada en nuestra página web www.cancer.gov.co link contrataciones

SEPTIMA PREGUNTA

“...

ITEM 4 MONITOR DE SIGNOS VITALES CON ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS:


1.2 Pantalla a color tecnología LCD tipo touch screen: Solicitamos se permita por sistema touch o por perilla, ya que generalmente esta opción le da mas vida útil a la pantalla del equipo.

...”

RESPUESTA

El Instituto Nacional de Cancerología – ESE, le manifiesta que la oferta comercial actual de equipos de esta gama, muestra que existen varias marcas que cuentan con esta especificación. Las pantallas touch screen ofrecen ventajas para el manejo por parte de los usuarios, haciéndola más amigable.

Atentamente

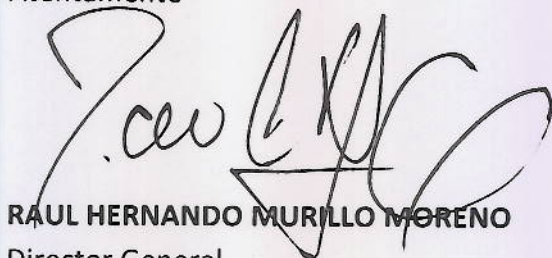

RAUL HERNANDO MURILLO MORENO
Director General

SGGAF/JJPA/GCCI/RECB/Carolina L.

Instituto Nacional de Cancerología E.S.E
Grupo Archivo General y Correspondencia
No. Radicación: SAL-03166-2014
Fecha de Rad.: 2014-05-08 09:16:34 AM
686976