



Instituto Nacional de Cancerología E.S.E
Grupo Archivo General y Correspondencia

No. Radicación: SAL-04258-2014

695052

Fecha de Rad.: 2014-06-12 09:24:45 AM

695052

Señora

MARY LUCY CALDAS CASTILLO

Jefe Nacional de Licitaciones

QUIRURGIL

Tel: 6169700 marylucy.caldas@quirurgil.com

Bogotá



Instituto Nacional
de Cancerología-ESE
Colombia
Por el control del cáncer

RESPUESTA: CONVOCATORIA PÚBLICA 051 DE 2014.

En respuesta al correo electrónico enviado el día 09 de Junio de 2014 a las 09:23 a.m., le manifiesto que:

PRIMERA PREGUNTA

" ... "

ITEM No. 12 - DOS (2) MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICOS

Dentro de las características técnicas requeridas para este equipo se encuentra:

1. "MONITOR CON PANTALLA LCD DE 7 PULGADAS, MONOCROMÁTICA". Solicitamos aceptar equipos con pantallas de 10 pulgadas a color, las pantallas monocromáticas no ofrecen comodidad visual para el usuario, no facilitan la visualización desde diferentes ángulos y al presentar trazos en un mismo color no es fácil identificar a distancia los parámetros pudiendo generar confusión. Las pantallas a color permiten configurar los parámetros por diferentes colores facilitando al usuario reconocer un trazo a distancia, actualmente para estos parámetros existe un estándar de identificación, ejemplo: ECG color verde, SPO2 color amarillo, PNI color rojo, RESPIRACION color azul, TEMPERATURA color blanco, etc., adicionalmente, las pantallas monocromáticas no ofrecen la misma resolución en calidad de imagen y la diferencia en el costo no es significativo.

...."

RESPUESTA

El Instituto Nacional de Cancerología – ESE, surtió adenda No. 2 la cual se encuentra publicada en la página web www.cancer.gov.co

SEGUNDA PREGUNTA

" ... "

2. "MEMORIA DE LAS ÚLTIMAS 72 HORAS PNI, SPO2, FRECUENCIA DE PULSO Y CURVA PLETISMOGRÁFICA". Para que la entidad pueda tener pluralidad de oferentes en el proceso, solicitamos aceptar equipos con un tiempo mínimo de 24 horas, condición que no afecta el desempeño y funcionalidad del monitor ya que esta característica es específica de una marca en particular.

...."

RESPUESTA

El Instituto Nacional de Cancerología – ESE, le manifiesta que en relación a su solicitud se aclara que es de vital importancia tener un amplio margen temporal en memoria, además de ser una característica que es ofrecida por más de una marca en el mercado colombiano.

re



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

PROSPERIDAD
PARA TODOS

Calle 1ª N° 9 - 85 / PBX: 334 1111
www.cancer.gov.co
Bogotá D.C., Colombia
NIT: 899.999.092 - 7

TERCERA PREGUNTA

" ... "

3. "EL EQUIPO DEBE INCLUIR SOFTWARE PARA SU OPERACIÓN COMPATIBLE CON LOS SOFTWARE DEL INSTITUTO, QUE PUEDA ACTUALIZARSE SIN COSTO ADICIONAL CADA VEZ QUE SE REQUIERA DURANTE LOS AÑOS DE FUNCIONAMIENTO Y/O VIDA ÚTIL DEL EQUIPO". Por favor aclarar a que hace referencia esta condición, que tipo de compatibilidad debe existir con el software. ..."

RESPUESTA

El Instituto Nacional de Cancerología – ESE, le aclara que con el fin de garantizar la necesidad de la institución frente al uso adecuado de los equipos que cuentan con software para su funcionamiento, se realiza una modificación a la redacción de esta especificación. Ver adenda modificatoria Ítem 12.

CUARTA PREGUNTA

" ... "

ITEM No. 13 - TRES (3) MONITOR DE SIGNOS VITALES


Dentro de las características técnicas requeridas para este equipo se encuentra:

1. "EL EQUIPO DEBE INCLUIR SOFTWARE PARA SU OPERACIÓN COMPATIBLE CON LOS SOFTWARE DEL INSTITUTO, QUE PUEDA ACTUALIZARSE SIN COSTO ADICIONAL CADA VEZ QUE SE REQUIERA DURANTE LOS AÑOS DE FUNCIONAMIENTO Y/O VIDA ÚTIL DEL EQUIPO". Por favor aclarar a que hace referencia esta condición, que tipo de compatibilidad debe existir con el software. ..."

RESPUESTA

El Instituto Nacional de Cancerología – ESE, surtió adenda No. 2 la cual se encuentra publicada en la página web www.cancer.gov.co

Atentamente

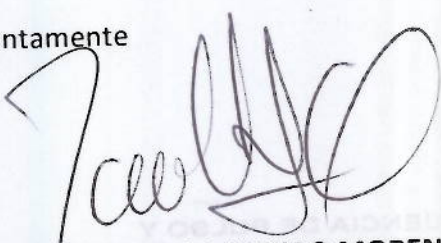

RAUL HERNANDO MURILLO MORENO
Director General

SGGAF/JJPA/GCCI/RECB/Asotelo