

222572

Señora

MARIBEL BUSTOS

COMERCIAL

CHAHAR S.A.S.

Ingeniería Hospitalaria

PBX 7 1 257 19 00 EXT 112 Cel:3103220450

Bogotá D.C.

ASUNTO: OBSERVACIONES A LA INVITACIÓN A COTIZAR No. 044-2017


Respetada Señora Maribel:

PRIMERA PREGUNTA:

..."Respecto a los resultados publicados hasta la fecha, requerimos que se realice una nueva calificación técnica sobre las especificaciones que requiere el INC para el Ítem 2 Reguladores de Vacío; con base en la revisión de propuestas realizada el día 21 de abril por nuestra firma.

1. Garantía y vida útil del regulador de vacío: Podemos ver que los oferentes Biomédicos asociados y South medical ofrecen vidas útiles en los reguladores de vacío ofertados, inferiores a la garantía (6 años) que ofrece la marca VACUTRON BY CHEMETRON, y una vida útil superior a 12 años. Invitamos a tener en cuenta esta característica del Regulador de vacío VACUTRON.

REGULADOR DE VACIO	CHAHAR	BIOMEDICOS	SOUTH MEDICAL
PRECIO	\$ 1,122,170	\$ 654,500	\$ 1,055,250
GARANTIA MINIMA (2) AÑOS	6 AÑOS	2 AÑOS	2AÑOS
ESPECIFICAR VIDA UTIL DEL	12 AÑOS	5 AÑOS	
MARCA	Chemtron Americana	Amico Canadiense	Gentec Chino
CONECTOR CHEMETRON	Original Chemtron	Tipo Chemtron Plastico	Tipo Chemtron

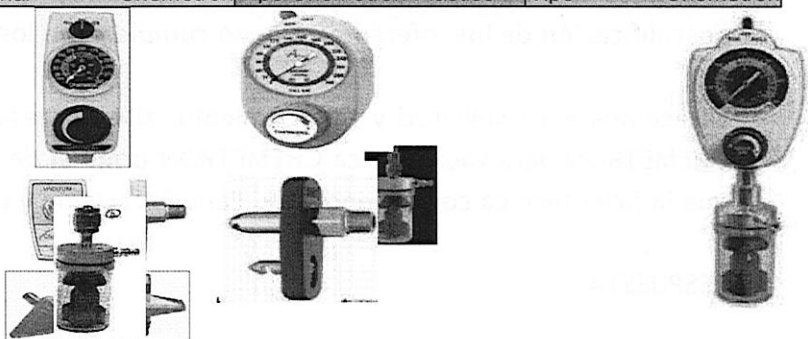

RESPUESTA:

La especificación técnica solicitaba como requisito para dar cumplimiento una garantía mínima de dos años, por lo cual a cada oferente se le evaluó como cumple el ítem que hacía referencia a la misma.

No es posible dar una puntuación, debido a que la forma de evaluar es de cumplimiento o no.

SEGUNDA PREGUNTA:

...”En el Anexo 4 Especificaciones técnicas en ACCESORIOS el numeral 2; solicitan un conector CHEMETRON.

- A. Los oferentes Biomédicos Asociados y South Medical Ofertan Conectores Tipo Chemetron, por lo cual en primera instancia no cumplen con las especificaciones requeridas por el proponente donde solicita marca CHEMETRON mas no Tipo Chemetron.
- B. A parte de la marca, los componentes tampoco cumplen con el requerimiento técnico, los cuales son contruidos en plástico con componente metálico, este conector tiene el riesgo de fugas al no tener ajuste preciso con el escudo de la toma a la que conecta. Esto no corresponde a un CONECTOR CHEMETRON, ya que las especificaciones técnicas del conector Chemetron, es construido totalmente en Bronce cromado y no tiene ningún componente plástico, esto a razón de que necesita hacer ajuste preciso con el gas medicinal, en este caso Vacío quirúrgico.

El único proponente que presento en su cotización un CONECTOR CHEMETRON, fue Chahe SAS, quien oferto CONECTOR CHMETRON original construido totalmente en bronce cromado, sin componente metálico. Según lo anterior descrito requerimos la descalificación de los oferentes que no cumplen con los parámetros requeridos.

Ofrecemos a su solicitud y requerimiento, si es necesaria, una muestra de CONECTOR CHEMETRON para vacío marca CHEMETRON original de fabricación americana, lo mismo que la ficha técnica correspondiente. Para su revisión y comprobación...”

RESPUESTA:

La solicitud en las especificaciones técnicas publicadas en la Invitación 044-2017 tenía como objetivo la participación plural de oferentes, por lo cual no se solicitan equipos de determinada marca. Para el caso particular, se solicitaba en el numeral: 1.11 Conexión

tipo chemetron y luego el apartado de ACCESORIOS: 2. Un (1) Conector chemetron; nunca se mencionó conector marca chemetron, ya que si bien es una marca, también a nivel genérico se ha denominado comercialmente chemetron a la forma del conector, y varias marcas ofertan el conector con el nombre antes citado, tal cual pudo ser verificado durante su revisión de carpetas.

Por lo anterior, además de resaltar que nunca se solicitó un conector específico de marca chemetron se mantiene la calificación como cumple para los ítems 1.11 Conexión tipo chemetron y 2. Un (1) Conector chemetron, a los tres proveedores.



CAROLINA WIESNER CEBALLOS
DIRECTORA GENERAL (E)

Revisó: Rubia Elicelly Cardenas Bayona – Coordinadora Grupo Área de Gestión Contractual 
Juan Jose Perez Acevedo – Subdirector General de la Gestión Administrativa y Financiera

DG/CWC/SGGAF/JJPA/GAGC/RECB/Erika

