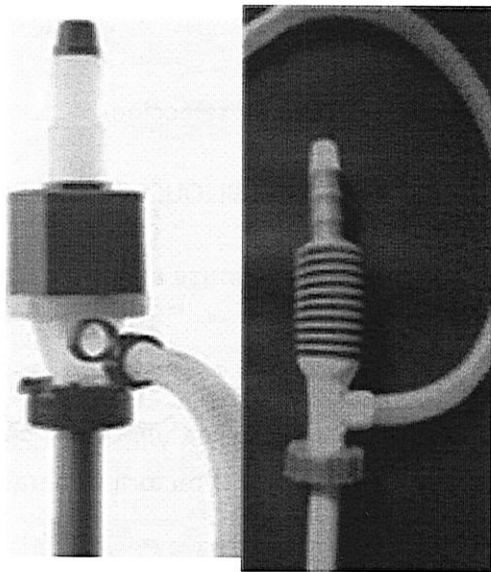
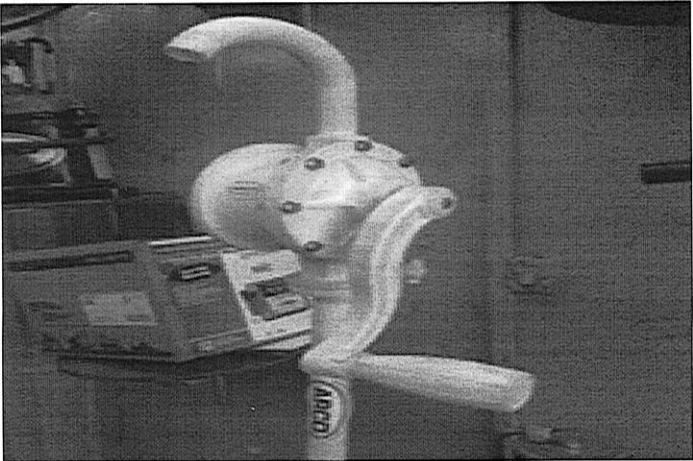


CONSIDERACIONES

- Que el Instituto Nacional de Cancerología - Empresa Social del Estado, cursó la Invitación a cotizar No. 315 de 2018, para la compra y adquisición de elementos de protección personal e insumos, de alturas, emergencias y confort, de acuerdo con las condiciones establecidas en los presentes términos de condiciones, sus anexos y adendas, documentos que formaran parte integral del contrato que se celebre para tal efecto.
- Que los términos de condiciones que dieron apertura a la Invitación a cotizar No. 315 de 2018, fueron publicados en la página Web del Instituto Nacional de Cancerología - Empresa Social del Estado (www.cancer.gov.co) el día 11 de abril de 2018.
- Que el día 25 de Abril de 2018, a las diez de la mañana (10:00 a.m.), se efectuó el cierre acorde con lo establecido en la referida invitación y de acuerdo con la planilla de recepción de ofertas no se presentó oferente alguno para el ítem del grupo No. 2.
- Que el comité de apoyo a la actividad contractual en sesión efectuada el día 26 de junio de 2018, como consta en Acta No. 44 - ítem No. 03 con fundamento en la verificación se observó que no hubo concurrencia de oferentes por el ítem relacionado a continuación:

GRUPO No. 1. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL.

REFERENCIA	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
80130317	BOMBA MANUAL MANEJO QUIMICOS	Descripción: Bomba manual de alta resistencia para bombear líquidos o químicos desde canecas o barriles. Longitud del tubo: 85 cm que puede ser reducido. Material: Cuerpo y tubo de descarga y succión en polipropileno. Capacidad de succión: 21 litros por minuto en promedio.  BOMBA DE SUCCIÓN PLÁSTICA OPCIÓN 2: Bomba rotativa plástica manual para transferir fluidos a base de agua, anticongelantes, gasolina, ácidos, productos químicos y derivados del petróleo desde canecas o barriles.	100

REFERENCIA	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
		Material: Cuerpo y tubo de descarga y succión en polipropileno, sellos internos en caucho de viton, partes metálicas en acero inoxidable para uso con canecas. Capacidad de succión: 5 litros por cada 20 vueltas. Diámetro de succión 1/2 pulgada de descarga.  Anexar ficha técnica y muestra.	

En mérito de lo expuesto,

La Directora General del Instituto Nacional de Cancerología - Empresa Social del Estado, con fundamento en los considerandos antes mencionados procede a:

PRIMERO: Declarar desierto el ítem de la invitación a cotizar No. 315-2018

SEGUNDO: Publíquese la presente acta en la página Web del Instituto Nacional de Cancerología - Empresa Social del Estado.

TERCERO: Dar inicio a un nuevo proceso de selección.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,

Dada en la ciudad de Bogotá D.C., a los veintiséis (26) días del mes de Junio de 2018.



CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Directora General

o Bo: Juan José Pérez Acevedo - Subdirector General de la Gestión Administrativa y Financiera.
Vo Bo: Wilson Ibarguen Lozano - Coordinador Grupo Área Gestión Contractual (E).
Elaboró: Diego Rojas - Auxiliar Administrativo Grupo Área Gestión Contractual.